



201412341438
有效期至:2026年01月08日



检测编号: JH202111113 202111115

委托单位 江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称 鄱阳县垃圾焚烧发电厂废气排放检测

检测类别 车线比试手吸检测

报告日期 2022 年 01 月 14 日

江西九环检测有限公司

Jiangxi Jiuhuan Test Co., Ltd

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

编

制

审

核

签字
周国良

签

发


签发日期

2022.1.14

签发人职位


授权签字人

(检验检测专用章)

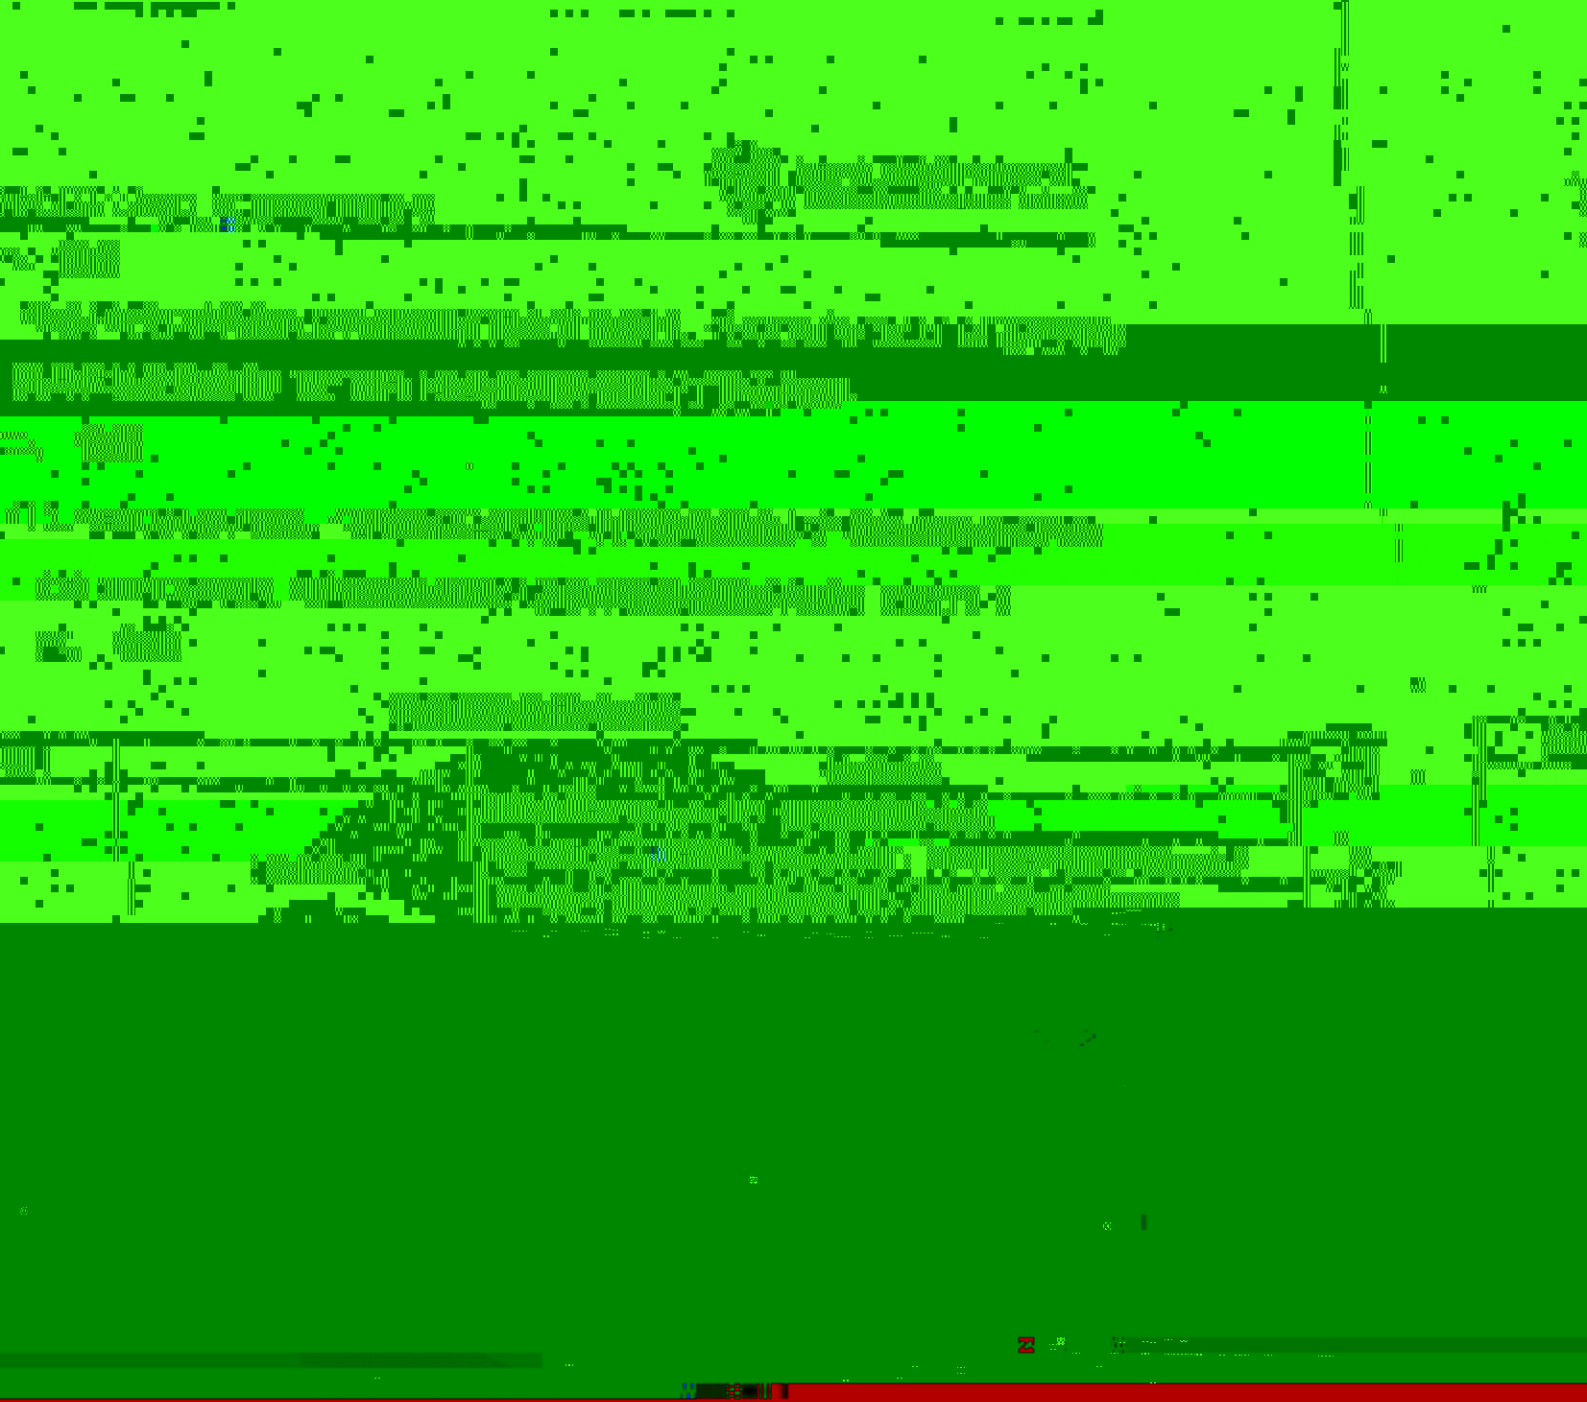

24 湿度	湿度	湿度 5.0%时，绝对误差不超过±1.5%
-------	----	-----------------------

名称	型号	品牌	制造单位	仪器		
系统	EM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天	CEMS		
分析仪	PM5-100	后散射式	抚州泽天	颗粒物		
硫分析仪	EM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天	二氧化硫		
氮物分析仪	PM5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天	氮氧化物		
氧量分析仪			抚州泽天			
烟气流速			抚州泽天			
烟气温度	PT-300	铂电阻	抚州泽天			
项目	CEMS 数据均值	参比方法值	单位	比对监测结果	限值	结果评定
					绝对误差不超过	达标
二氧化硫	20.433	20.9	mg/m ³	0.467	绝对误差不超过±17mg/m ³	达标
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m ³	22	绝对误差不超过±41mg/m ³	达标
烟气流速	13.32	13.5	m/s	-1.3	相对误差不超过±10%	达标
烟气温度	140.755	144.1	°C	-0.31	绝对误差不超过±3°C	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47	相对准确度<15%	达标
湿度	21.28	21.35	%	-0.33	相对误差不超过±25%	达标
氯化氢	25.763	4.7	mg/m ³	19	/	
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		

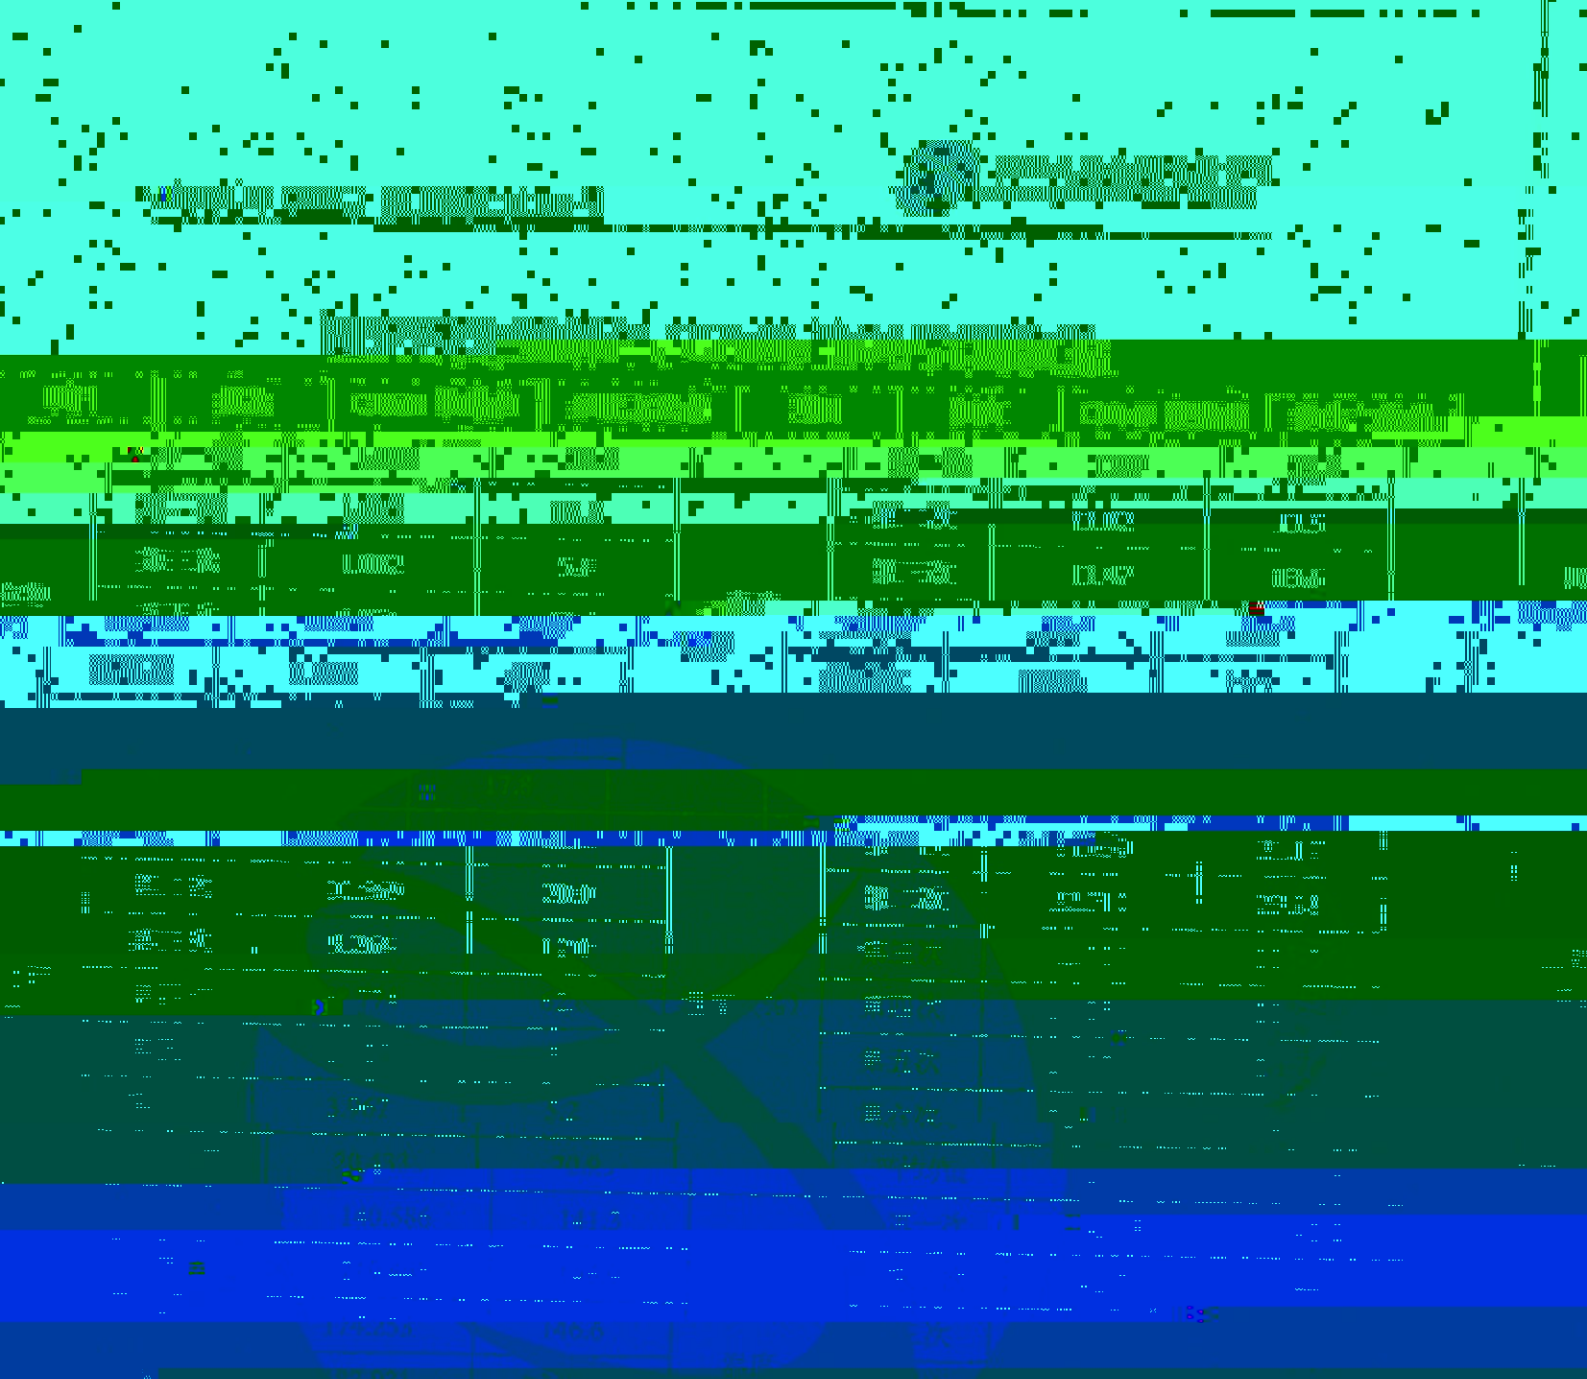

氯化氢 (mg/m³)				氯化氢 (%)			
第五次		132.930	146.9	第五次		137.060	137.1
第六次		153.020	146.9	第六次		141.000	141.1
平均值		168.028	146.3	平均值		140.785	141.1
第一次		30.704	7.8	第一次		0.103	0.2
第二次		36.651	3.5	第二次		0.137	0.1
第三次		15.247	7.0	第三次		0.065	0.0
第四次		31.914	3.2	第四次		0.041	0.4
第五次		10.145	3.4	第五次		0.108	1.0
第六次		17.917	3.4	第六次		0.092	0.0
平均值		23.763	4.7	平均值		0.087	0.3

江西
续表