



231712050363



迅捷检测

检测报告

迅捷检测有限公司

检测有限公司

检测

检测




- 西安和丰会计师事务所有限公司，请在收到报告之日起十个工作日内以书面形式向本公司提出书面异议。同时附上提出异议的书面材料。

12. 1990年12月1日以前，在“ ”中， 的 。

[illegible]

北田建設有限公司

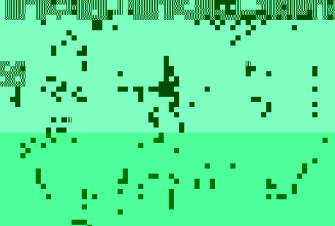



报告编号: 迅捷检字[2024]X884号

检测报告

一、检测情况

- 1、项目名称: 2024年8月27日送检样检测
- 2、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 3、联系方式: 19971570032
- 4、送检时间: 2024年8月27日

送检样图片见附图 1。

二、检测结果

送检样检测结果见表 1。

表 1 送检样检测结果统计表

样品标识	实验室样品编号	样品名称	检测项目	单位	检测结果
			六价铬	mg/L	ND
			汞	mg/L	ND



3. 样品的保存、检测过程均按《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)等国家规定的技术规范进行,并采取了平行双样、加标样、留样复检等措施进行质量控制。

五、检测结论

	检测项目	结果评定			
		实验室平行	加标回收	质控样	
	铬	合格	/	合格	
	铜	合格	/	合格	

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目检测送检样所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表3。

表3 检测项目检测方法、主要仪器及检出限


序号	检测项目	检测方法	主要仪器	检出限
1	铬	电感耦合等离子体原子吸收光谱法	ICP-AES	0.01mg/L
2	铜	电感耦合等离子体原子吸收光谱法	ICP-AES	0.01mg/L




固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	ICP-MS 7800 型 电感耦合等离子 体质谱仪	XJF-X011-01	0.1-10000	10	10
固体废物 金属元素的测定	ICP-MS 7800 型				10

ICP-MS 7800 型	电感耦合等离子 体质谱仪	XJF-X011-01	0.1-10000	10	10
ICP-MS 7800 型	电感耦合等离子 体质谱仪	XJF-X011-01	0.1-10000	10	10

湖北迅捷检测有限公司



湖北迅捷检测有限公司






迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2024]X884'号

附图 1: 送检样图片

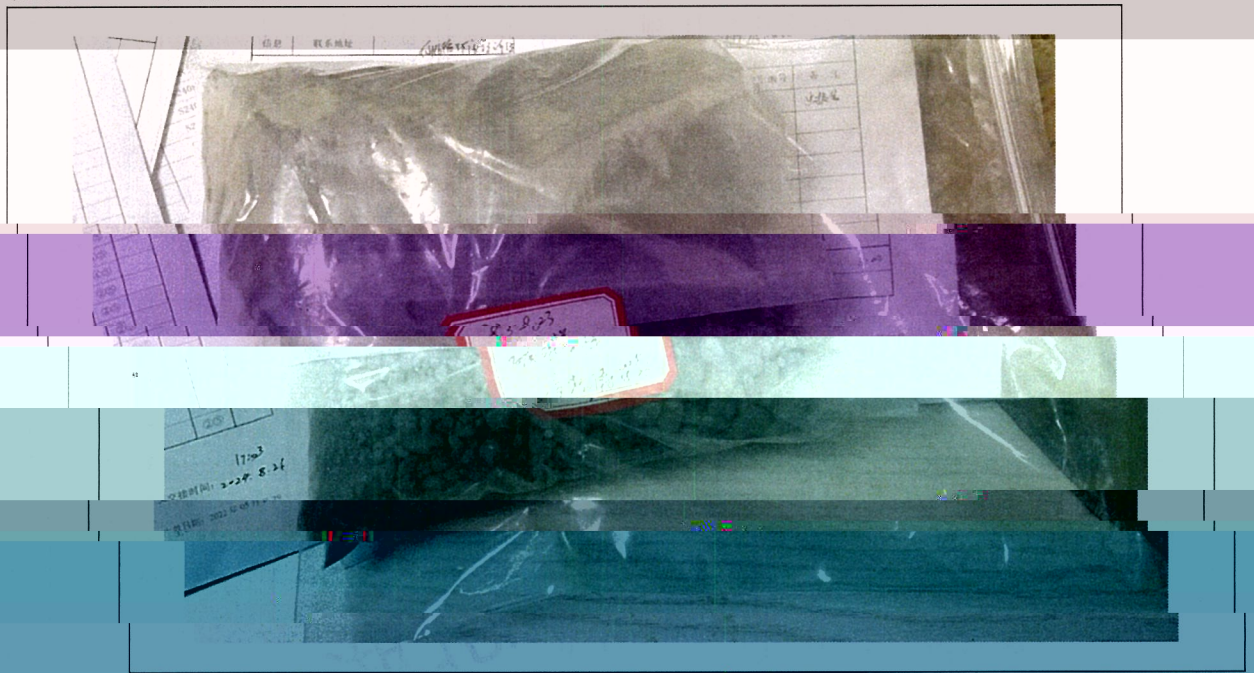

编制: 审核: 签发:

日期: 2024.9.10 日期: 2024.9.10 日期: 2024.9.10